

か ら が

柔整Version

サ イ エ ン ス









☆巻頭ビッグインタビュー

『人間らしさを失わない医療と看護を求め続けて!』 川嶋みどり 氏

■『柔整の明るい未来を切り拓くために
保険者との信頼関係の構築を目指して!』 本多 清二 氏

◇all for one, one for all 共に生きる
—医療の最底辺を支える— 酒田 達臣 氏

■東洋医学の謎を解明する (最終回) 川村 昇山 氏

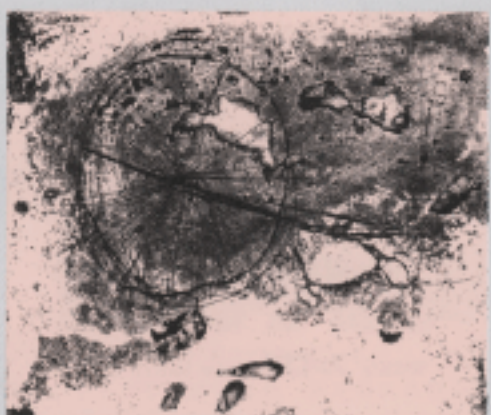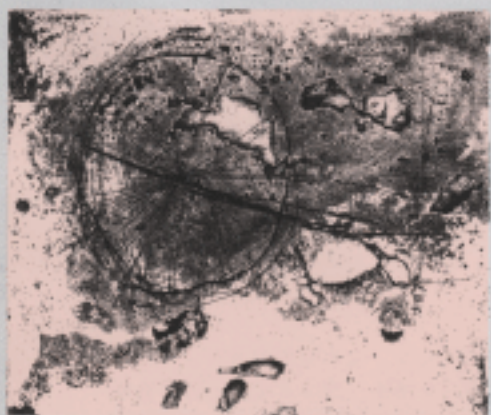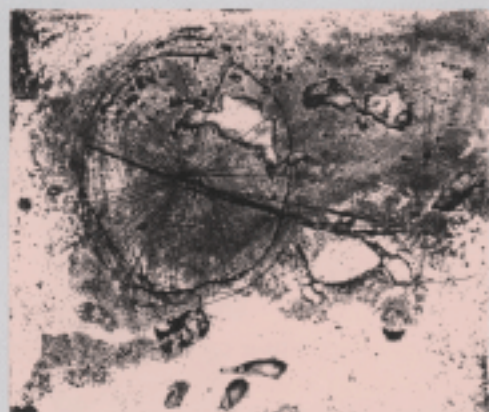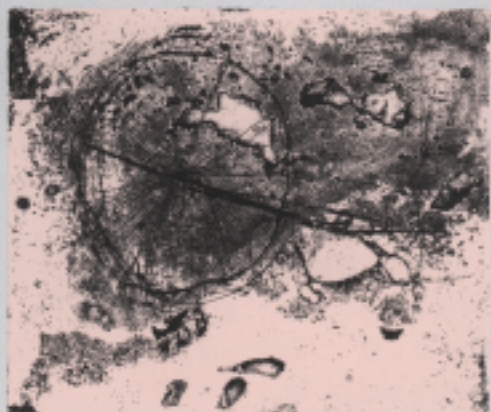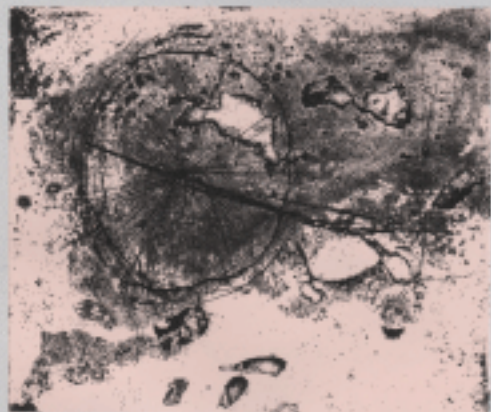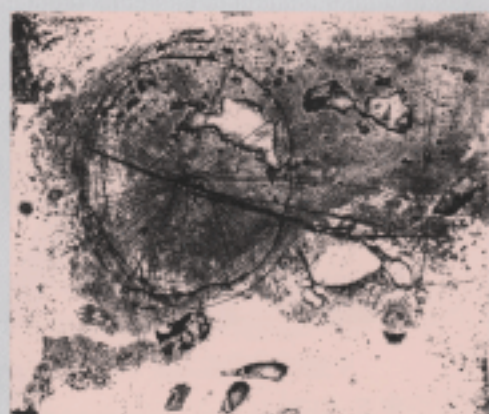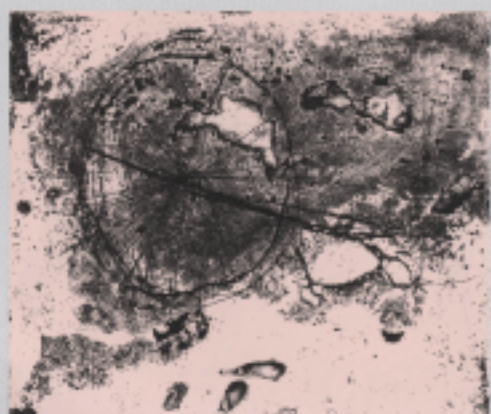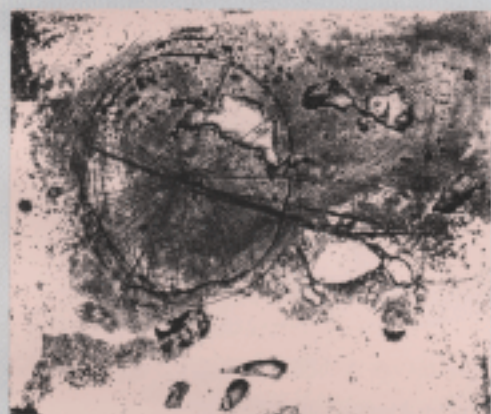

2013.12月
第113号

効果の少ない装具とは…

Q1
プラス

『矯正力の高い大塚整体指導装具と効果の少ない装具』

大塚整体治療院 院長 大塚 乙衛

矯正力の高い大塚整体指導装具

大塚整体指導装具には右胸椎部・左腰椎部・左前肋骨にパッドが入っており、装具完成後も身体の成長に合わせてパッドやベルトの位置を随時調整し、高い矯正効果を常に維持し続けます。また、装具は毎回必ず装着時の矯正効果を確認し、修正していかなければならない。


実用新案登録済み

大塚整体指導装具は実用新案登録済みです。考案名称「肋骨隆起・腰部隆起改善／延長パッド及び筋交いベルト」



☆プラスワンの治療法として、いま注目の治療技術についてご紹介しています。

側弯状況に応じた矯正力のある装具タイプ

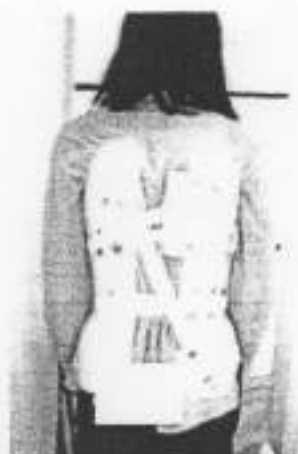

大塚整体指導装具を製作できるのは、日本で株式会社アスカの1社のみ。1級技能大川装具士しかいません。尚、この装具の製作は、大塚整体の指導及び許可が必要です。

効果の少ない装具とは

歪んだ身体に合わせて製作された装具では、矯正力が無い。



効果の少ない装具とは…

右胸椎の右弯曲に対して彎曲部分の背部に装具が届いていない為、矯正力が無い。



左前肋骨にパッドが無い装具は、肋骨弓が突出してしまい体形が変形する。



最も悪い装具は「パッドの無い装具」です。この装具タイプで夜に寝ると、背中部分がブカブカになりリブハンブ(でっぱり)を抑える矯正効果が無い。



多くの病院の医師や装具社はこのことを知りません。ここまで装具の効果を確認するところはありません。これが、今後の日本における側弯症治療装具の重要課題です。

詳しくは、「医療連携側弯症予防改善学会<http://sokuwankaizen.com>」、「大塚整体治療院<http://www.sokuwan.com>」、からだサイエンス2月号、4月号、6月号、8月号、10月号をご覧ください。